




I • Maschine aufstellen



II • Bedienung



▶ Rezeptauswahl / Rezeptstart

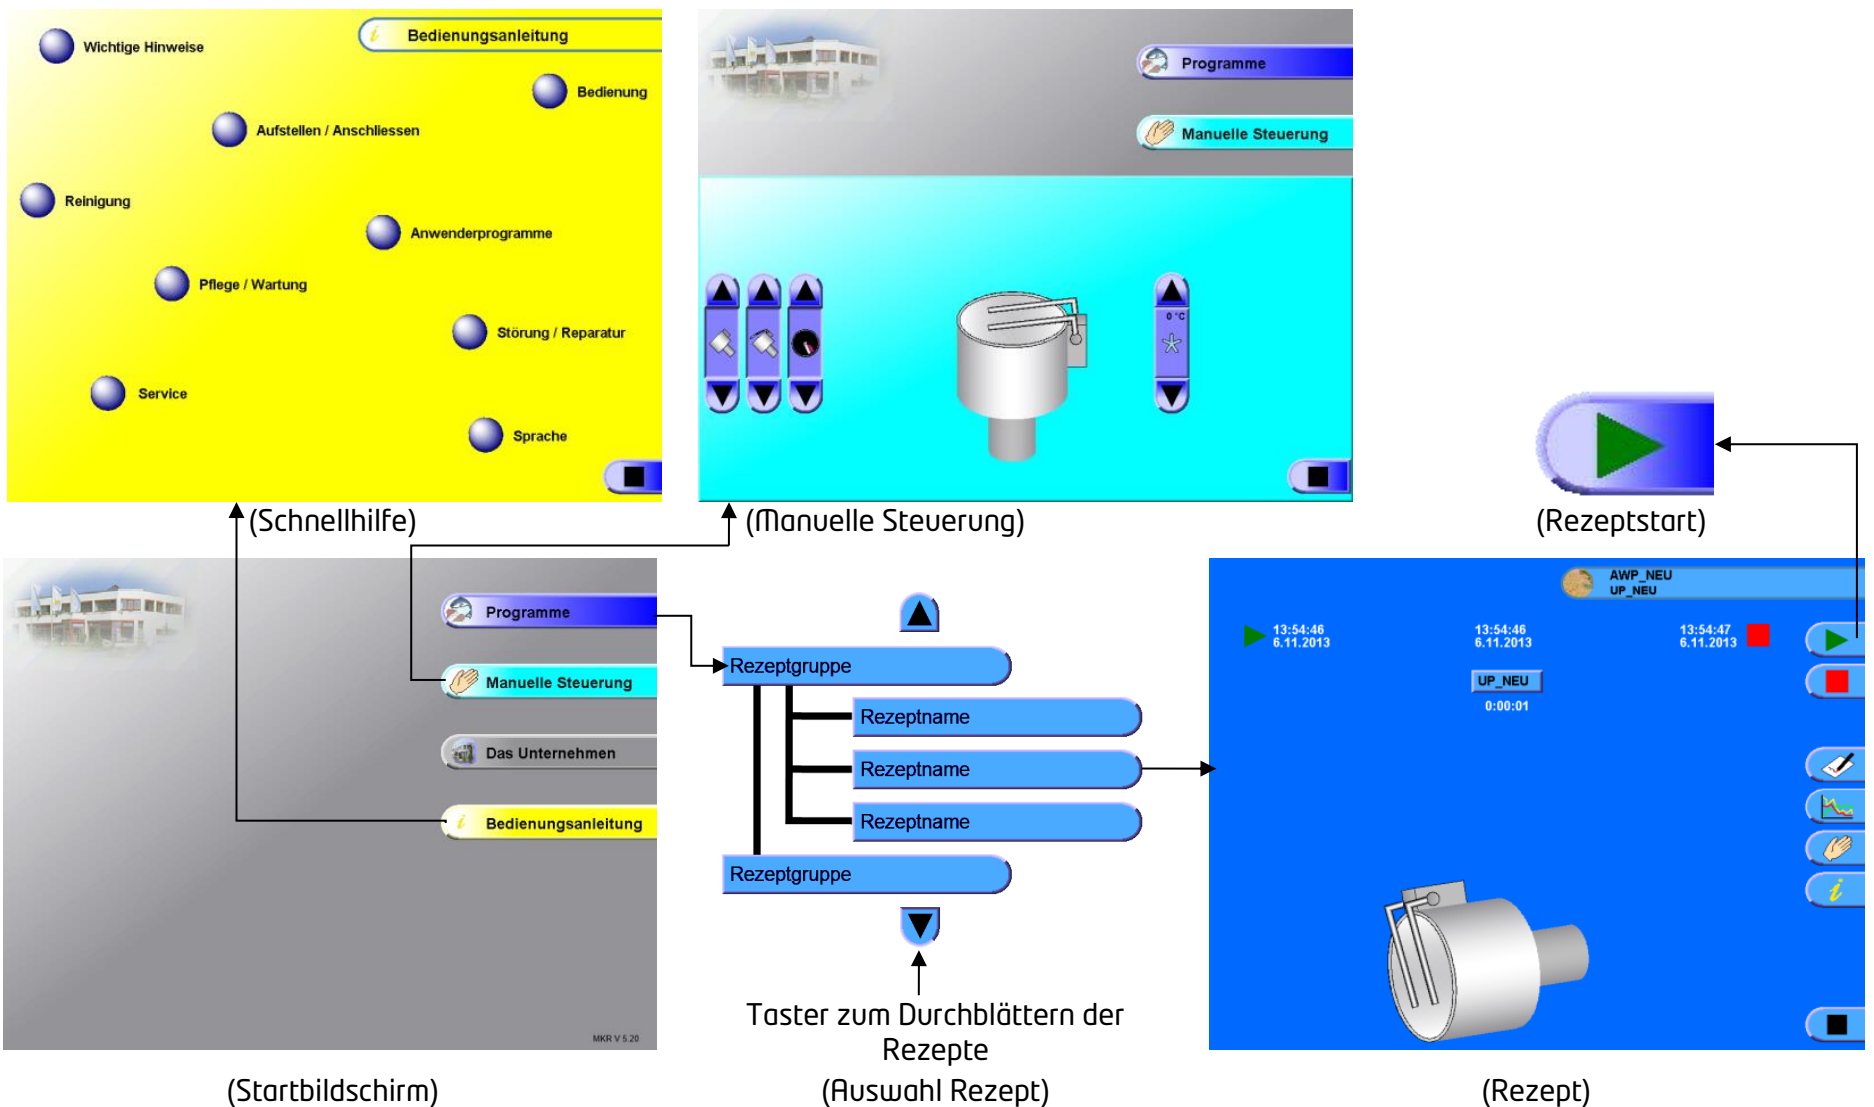

▶ Rezeptauswahl / Rezeptstart

AWP_NEU
UP_NEU

13:54:46
6.11.2013

13:54:46
6.11.2013

13:54:47
6.11.2013

UP_NEU
0:00:01

Rezeptname

Start / Pause

Stop

Phasen

Rezepteditor

Statistik

Manuelle Steuerung

Information Ein / Aus

Zurück

(Rezepte erstellen)

Editor
Passwort 0

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	X	✓

Werkseinstellung
Passwort = „0“

✍ Programmierung / Neuanlage Rezept

Phasenüberblick

Bestehende Phasen einfügen

Zurück

Neue Phasen einfügen

Aktive Phase kopieren

Aktive Phase löschen

Phasenkopf

Zeit

Temperatur

U/min Polterabstreifarm

Vakuum

Entkeimung

Trommelposition

Deckelposition

AWP_NEU
TumbleIt

1
UP_NEU
1 mal
1 Phase
00:00:01
00:00:01

Neuanlage Rezept:

Originales AWP
AWP_NEU

Neues AWP
AWP_NEU

Kopieren Umbenennen

Neu Löschen

1) „Neues AWP“ benennen
2) „Kopieren“ drücken

✋ Manuelle Einstellungen

Polterabstreifarmtaster (Linkslauf / Rechtslauf)

Deckelpositionstaster

Trommelpositionstaster

Rezeptauswahl

Programme

Manuelle Steuerung

Starttaster Kühlung

Zurück

III • Reinigung

